

综合·要览

2015年中国工程院增选院士70名,总参驻洛某研究所任辉启研究员当选 我市“两院”院士增至6名

□记者 潘立阁 通讯员 张炜

昨日,《洛阳晚报》记者从市科技局获悉,广受关注的中国工程院院士2015年增选名单于日前正式公布,此次共新增70名院士。其中,解放军总参某部驻洛某研究所任辉启研究员当选土木、水利与建筑工程学部院士。

任辉启,1953年生,现为总参某研究所研究员,先后获得北京大学固体力学学士、中国科学技术大学爆炸力学硕士、西南交通大学工程力学博士学位。他长期从事防护工程科研工作,曾多次获得国家自然科学二等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖等奖项。

至此,我市“两院”院士增至6名,其中中国科学院院士1名,为陈俊武院士;中国工程院院士5名,分别为李俊贤院士、王梦恕院士、顾金才院士、樊会涛院士和任辉启院士。


相关链接

中国工程院院士

中国工程院院士是国家设立的工程科学技术方面的最高学术称号,每两年增选一次。2015年院士增选工作于今年1月正式启动,通过中国科协组织学术团体提名和院士提名两条途径,共提名了521名有效候选人,经过两轮严格评审,最终评选出70名院士。此次工程院新增院士中,年龄最小的47岁,年龄最大的73岁,平均年龄56.2岁。

中国科学院院士

中国科学院院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号。7日,中国科学院公布2015年院士增选结果,61位科学家从157位初步候选人中脱颖而出,荣登新院士榜。经过增选,中科院现有院士777名。

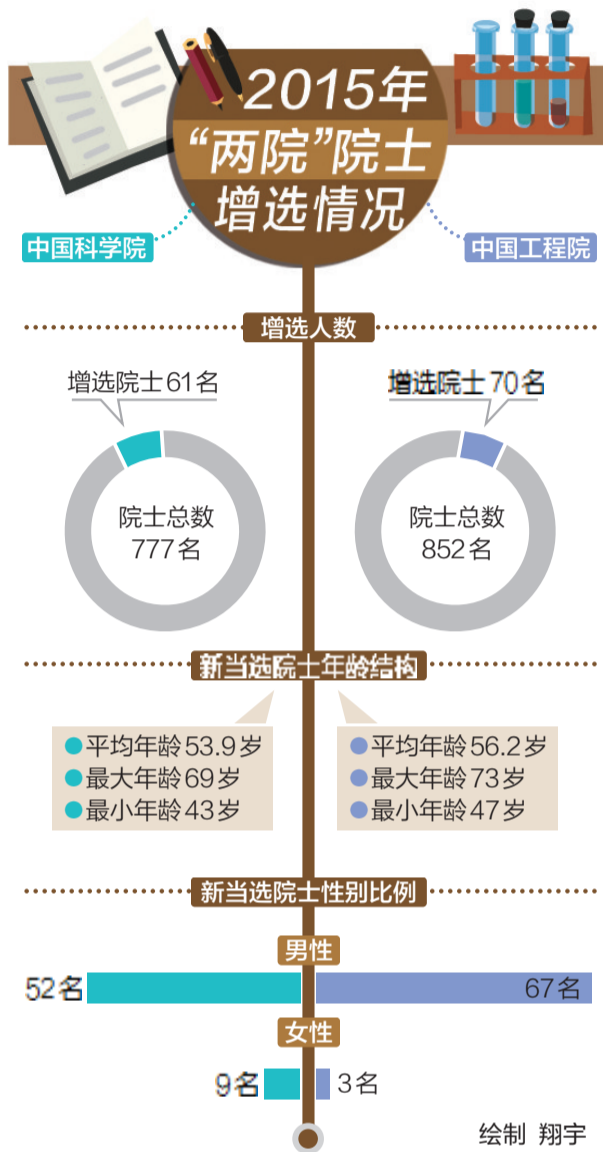

我省将为医疗机构装“电子眼” 药不对症将亮“红灯”

□据 新华社郑州12月8日电

记者8日从河南省卫生计生委了解到,从12月20日起,河南省将开始试点新农合智能审核系统,为定点医疗机构装上“电子眼”,各种不规范用药行为将由事后监督变为实时监控,预防过度医疗。

据了解,目前该系统根据河南省新农合有关政策规定及临床诊疗规范,初步建立了河南省智能审核系统知识库,在此基础上筛选确定药品类、诊疗类、疾病类和其他类等四大类审核规则。按照审核结果的性质和可疑程度,审核规则分为A、B、C三个级别:A级为违规行为明确,无需人工核查的;B级为可疑程度较高,人工核查难度较小的;C级为可疑度较低,或涉及问题较复杂,核查难度较高的。

按规划,今年12月20日,河南省将率先在10个市、县(市、区)和6家省级医疗机构启动首批智能审核试点;2016年3月全面启动河南省级定点医院智能审核试点,并进一步扩大市、县级试点范围;2016年年底实现河南全省覆盖。

据悉,如果出现医生接到“警示”后,依然不管不顾的情况,卫生部门将会组织专家对这次诊疗行为进行评估,确属违规的,当地农合办将拒付相关费用,并对违规行为较严重的医院和医务人员提出处理意见。

